

医療ガス容器 点検 キャンペーン

2023年

10/1(日)~11/30(木)まで

Check!!
Check!!

容器の一齐点検


- 容器の保管状況の確認
(転倒防止措置、充空及び異種容器の区別等)
- 調整器やバルブの不具合等、事故誘因容器の確認
- 長期停滞容器の発見・把握

職員研修のサポート

- 医療ガス安全管理委員会が行う院内講習会をサポートし、
容器の安全な取扱方法の啓発を推進

ボンベの長期留置又は放置による事故の発生
及び空ボンベの誤使用を防止するため、医療ガス納入
業者と協議の上、納入時期を明示するなどして
定期的にボンベの点検及び管理を行うこと。

令和3年12月16日医政発1216第1号厚生労働省医政局長通知「医療ガスの安全管理について」における「別添4. 医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」の医療ガスボンベの安全管理に関する留意点

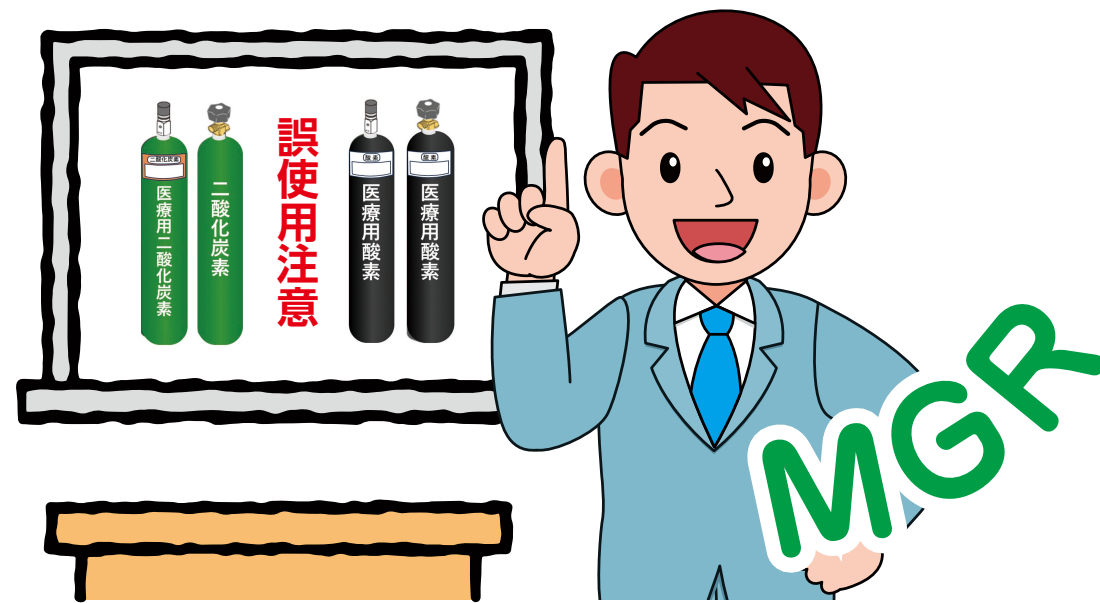

MGR: 医療ガス情報担当者